

ヒアルロン酸 Na 関節注 25mg シリンジ「トール」 容器変更のお知らせ


平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、ヒアルロン酸 Na 関節注 25mg シリンジ「トール」のフィンガーグリップとプランジャーを変更いたしますのでご案内申し上げます。

記

【変更内容】

容器変更：フィンガーグリップとプランジャーを、バックストップ機能ありのものに変更

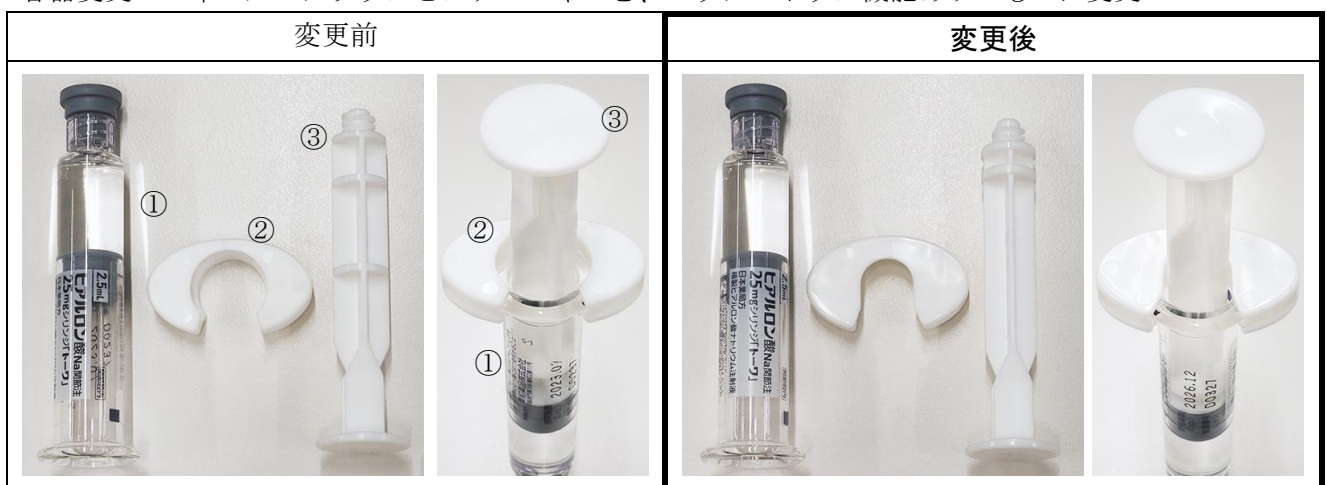

シリンジ部位名称：①シリンジ外筒 ②フィンガーグリップ ③プランジャー

バックストップ機能…シリンジ外筒からプランジャーの脱落を防止するための機能

<バックストップ機能なし>



プランジャーが抜け落ちる

<バックストップ機能あり>



プランジャーがフィンガーグリップに引っかかり、抜け落ちない

【個装箱表示】

しばらくの間、以下のように個装箱に表示いたします。

2.5mL×10 シリンジ…容器変更

【包装単位、変更ロット(使用期限)および出荷予想時期】

包装単位	変更ロット (使用期限)	出荷予想時期
2.5mL×10 シリンジ	D0327 (2026/12)	2024 年 1 月下旬

流通状況により変更品がお手元に届く時期が前後する場合がございますこと、ご了承下さい。

以上